

# TAKI ION MEDIC®

## 製品仕様 Specification

品名	医療用物質生成器 滝風ION MEDIC
外形寸法	W300×D79.5×H220(mm)
本体材料	難燃ABS (UL94 V-0)
重量	1,700g
電源	AC100V (50/60Hz共用)
消費電力	10W
放電方式	コロナ無声放電 (イオンターボチャージャー方式)
発生イオン濃度	200万ions/cc以上×12 (各吹き出し口)
発生オゾン濃度	0.020 ppm以下 (※測定値は0.020 ppm以下)

Made in JAPAN

メーカー希望小売価格

本体 **¥240,000**  
(税込 ¥264,000)

商標登録済 登録第5821474号  
商標登録済 登録第5821475号



NPO LUDPPAC 認証番号 B-0170  
生活習慣病予防学術委員会 認証

(NPO) 認定品

この商品の省エネ性能は



### ⚠️ 安全に関するご注意

※ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使い下さい。  
※燃焼器具と併用してご使用になる場合は、換気を行って下さい。

### ⚠️ 使用上のご注意

※寝室や、深夜等でかすかな運転音が気になる場合は「HIGHモード」スイッチをOFFしていただくことと快速にご使用いただけます。

滝風イオンメディックロゴ及びイオンメディック、ION MEDICは、株式会社アップドラフトの登録商標です。

⚠️ 最近「滝風イオンメディック」に酷似した類似商品が多数販売されております。これらの類似品は粗悪品であり「滝風イオンメディック」では御座いませんので、販売店にご確認のうえご購入くださいませ。

**UPDRAFT** <https://takiion.co.jp/>  
総発売元 株式会社 **アップドラフト**®  
〒982-0036 仙台市太白区富沢南1丁目22-11 1F  
TEL.022-304-1022 FAX.022-304-1023




■お問い合わせは

**株式会社 ミライ**  
〒814-0022 福岡市早良区原6-30-9-202  
TEL.092-407-8323 FAX.092-407-8324

送料/クロネコヤマト又は佐川急便にて送料無料。ただし、返品につきましては、お客様ご負担となります。代引手数料は無料です。  
返品可能期間/商品到着後8日以内  
保障期間/ご購入より1年。修理が必要とされる場合は早急に対応いたします。また、万一、お送りした商品に不良品がございましたら、直ちに新品と交換させていただきます。  
引渡時期/ご注文後、2~5日以内にお届けいたします。(在庫がない場合は、お届けまで2週間かかりますので、ご確認のうえ、ご注文をお願い致します。)  
お支払方法/クロネコヤマトによる商品代引き・銀行振込

空気のビタミン  
やすらぎの空間……

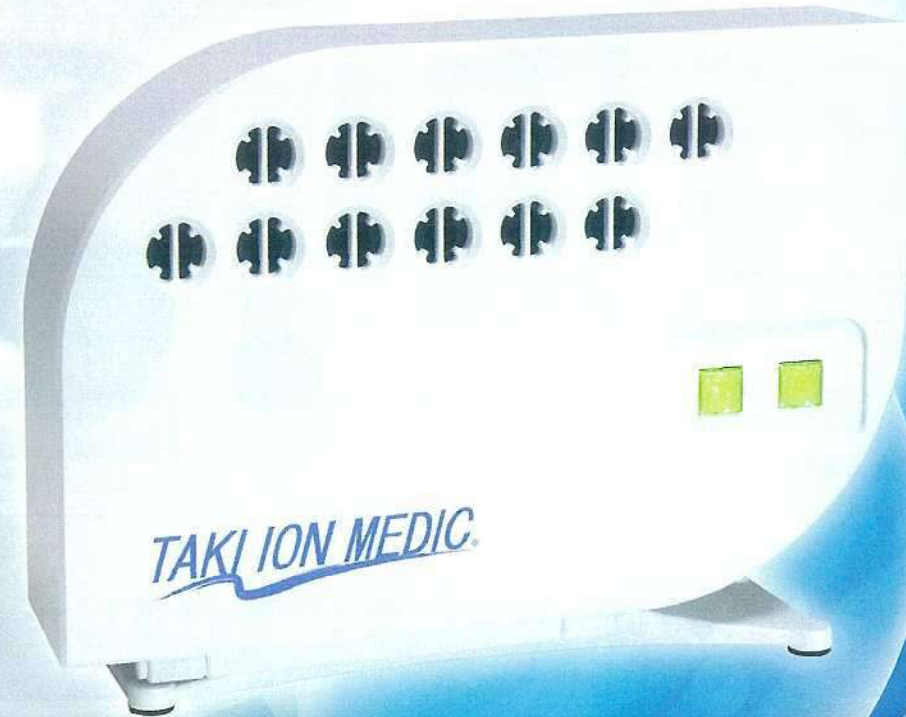

パールホワイト



JIS規格による  
**最高クラスの  
イオン発生量**

JIS(日本工業規格)による発生密度測定(JIS-B9929)において最高密度を表す「クラス6」の認定を日本機能性イオン協会より平成27年10月正式に滝風イオンメディックが認定された。

# TAKI ION MEDIC®

医療用物質生成器 (PSE)




# 無垢の空気 溶け込む“やすらぎ” 優しい力で大きな働き



## これがマイナスイオンの力

自然の中、とくに滝やせせらぎのそばの空気は清々しく感じます。そのワケは、空気中にマイナスイオンが多く含まれているからです。マイナスイオンは、心身のリラックスはもちろん、除菌・脱臭・集塵にも最適です。マイナスイオンは、「空気のビタミン」ともいわれ、生物に欠かすことのできない大切な空気中の要素です。「滝風 ION MEDIC」はマイナスイオンの働きに着目しました。大自然さえも上回る2400万ions(総数)以上のマイナスイオンを発生。しかもプラスイオンは全く出ていません。テレビなどの電化製品によって増加した、身体に悪影響を与えるプラスイオンを減少し、まるで森林浴をしているようなやすらぎを部屋の中に広げます。また、「滝風 ION MEDIC」は6畳から最大80畳まで対応できます。(部屋の環境や間取り、壁などにより変わります)

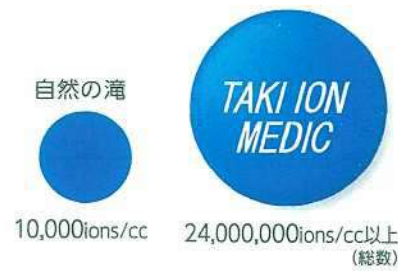


## インフルエンザウイルスの除去試験を受けました。

一般社団法人 北里環境科学センター調べ


### 浮遊インフルエンザウイルス除去試験

「滝風イオンメディック」のウイルス除去効果は、作動後15分間で対数減少値を示したことから、ウイルス除去効果があると判断されました。

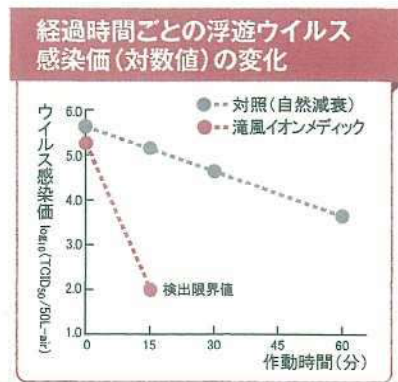

### 付着インフルエンザウイルス不活化試験

「滝風イオンメディック」のウイルス不活化効果は、作動後3時間で対数減少値を示したことから、ウイルス不活化効果があると判断されました。

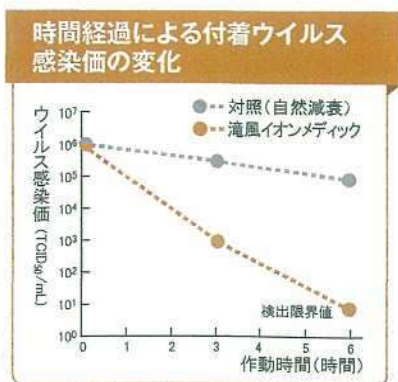


※実使用空間での実証試験ではありませんので、使用環境でのウイルスの抑制を保証するものではありません。また、健康状態等含めすべての条件で試験結果を保証するものではありません。

自然の滝の近くにいるような心地よさを体感してください。

脱臭・除菌・健康・環境エコロジー対策としてマイナスイオンには脱臭・除菌・集塵、健康に効果があります。滝風イオンメディックが発生させるマイナスイオンは、雑菌を滅菌し、タバコやペット臭などの気になる匂いも減少します。

## たった2時間で減菌!

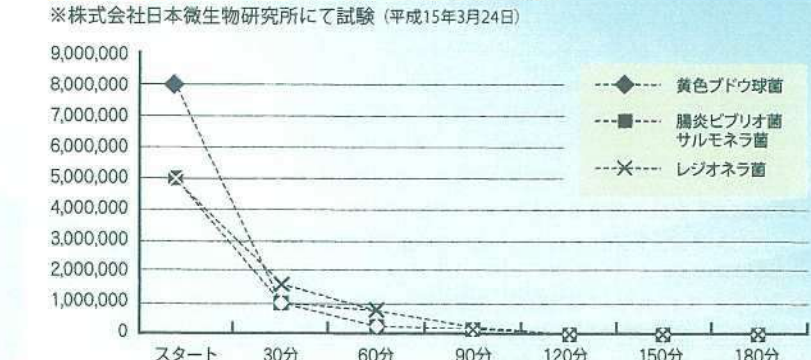

※実使用空間での実証試験ではありませんので、使用環境でこれらの菌の抑制を保証するものではありません。

- フィルターがありません(経済的)
- お手入れは誰でもカンタン!
- 気になる電気代は1ヶ月約90円(1日約3円)
- 移動もカンタン 片手で移動!!
- 最大80畳までOK!! (部屋の間取りや壁などにより変わります)

# 「滝風イオンメディック」は 滅菌・浄化力が強力です!!

※部屋の大きさや環境により変わります。

最大級のイオン発生量  
**イオンターボチャージャー方式**を採用  
イオンターボチャージャー方式により、やわらかなイオンが大量に発生し部屋中を自然の空間に演出します。  
【平成17年7月28日商標登録済】

**アレル物質・ウイルス分解・除去**  
お部屋のアレル物質・浮遊ウイルスを強力に分解・除去しますので、小さなお子様にも安心です。  
※部屋の大きさや環境により変わります。

**付着臭分解・除去**  
衣類に付いたイヤなニオイ成分を分解・消臭。梅雨時の部屋干し臭も吸着しないのでお部屋も、衣類もスッキリ。  
※部屋の大きさや環境により変わります。

**静電気(帯電)防止・除去対策に**  
電化製品に囲まれている私たちの生活が体調不良の原因と言われています。帯電を除去し静電気による不快感を解消します。  
※部屋の大きさや環境により変わります。



## お客様からの質問 Q&A

Q 電気代は？

A 1ヵ月連続で使用しても消費電力は10Wなので、毎日使用しても1ヵ月約90円程度で省エネです。

Q 保証期間は？

A 購入日から一年間の保証がついております。

Q どこに置いて使用すれば良いのですか？

A マイナスイオンは比重が重いので、出来るだけ高い所に置いて使ってください。本体が1.7kgと軽量ですので、持ち運びが便利です。

Q 10分くらいで良くなったけど毎日近くで吸うの？

A 今回は10分位で変化を見てもらうため、近くで吸っていただきましたが、通常はお部屋に置いてるだけでいいんですよ。最大80畳まで対応です。

Q 家にもマイナスイオンがありますが、どう違うの？

A 滝風イオンメディックは通常のマイナスイオン器の960倍以上イオンが出ますので、他には類を見ないイオン発生器なんです。

Q フィルターの交換は？

A 滝風イオンメディックはノンフィルターですので、交換は必要ありません。フロントパネルを開けていただき、集塵パネルをふき取るだけです。誰でも簡単に出来ます。

Q 窓を開けて使用しても良いのですか？

A 滝風イオンメディックは毎秒 2,400 万 ion/cc を発生しておりますので、窓を開けての使用もかまいません。

Q 寝室で使いたいのですが、音はうるさいですか？

A 寝室でご使用する場合は就寝前に HIGH ボタンを解除すればファンが半回転となり、気になるファンの音が止まります。

Q 使うときだけ電源を入れるのですか？

A 滝風イオンメディックの効果を発揮させる為には、電源を ON のまま継続することをお勧めします。

Q 集塵パネルのお掃除は何回くらい？

A 月に一度のお掃除をお勧めいたします。またご使用中に、パチパチと音がしましたら、ほこりが付着しておりますので、フロントパネルを開けてお掃除して下さい。

Q 健康機器はたくさんもっているのですが・・・？

A 健康機器はたしかにいいものがたくさんあります。ですが継続して使うことを長く続けるのは大変な労力がいらいます。滝風イオンメディックは使い忘れがないので、普段どおりの生活をしながら、自然に使い続けることが出来ます。ただ、呼吸をするだけですから・・・

Q オゾンの臭いが気になるのですが・・・？

A オゾン量は自然の基準値以下の量しか出ていませんので、吸っても体に影響は全くありません。臭いは最初は換気をしながら使ってください。場合によっては何らかの臭い成分を微量のオゾンが分解した際に発している臭いが残っている可能性があります。この場合も換気を継続しながら使用して臭いがなくなるのを待つのがよいです。